


# Procédure d'accès au marquage CE suivant la classe

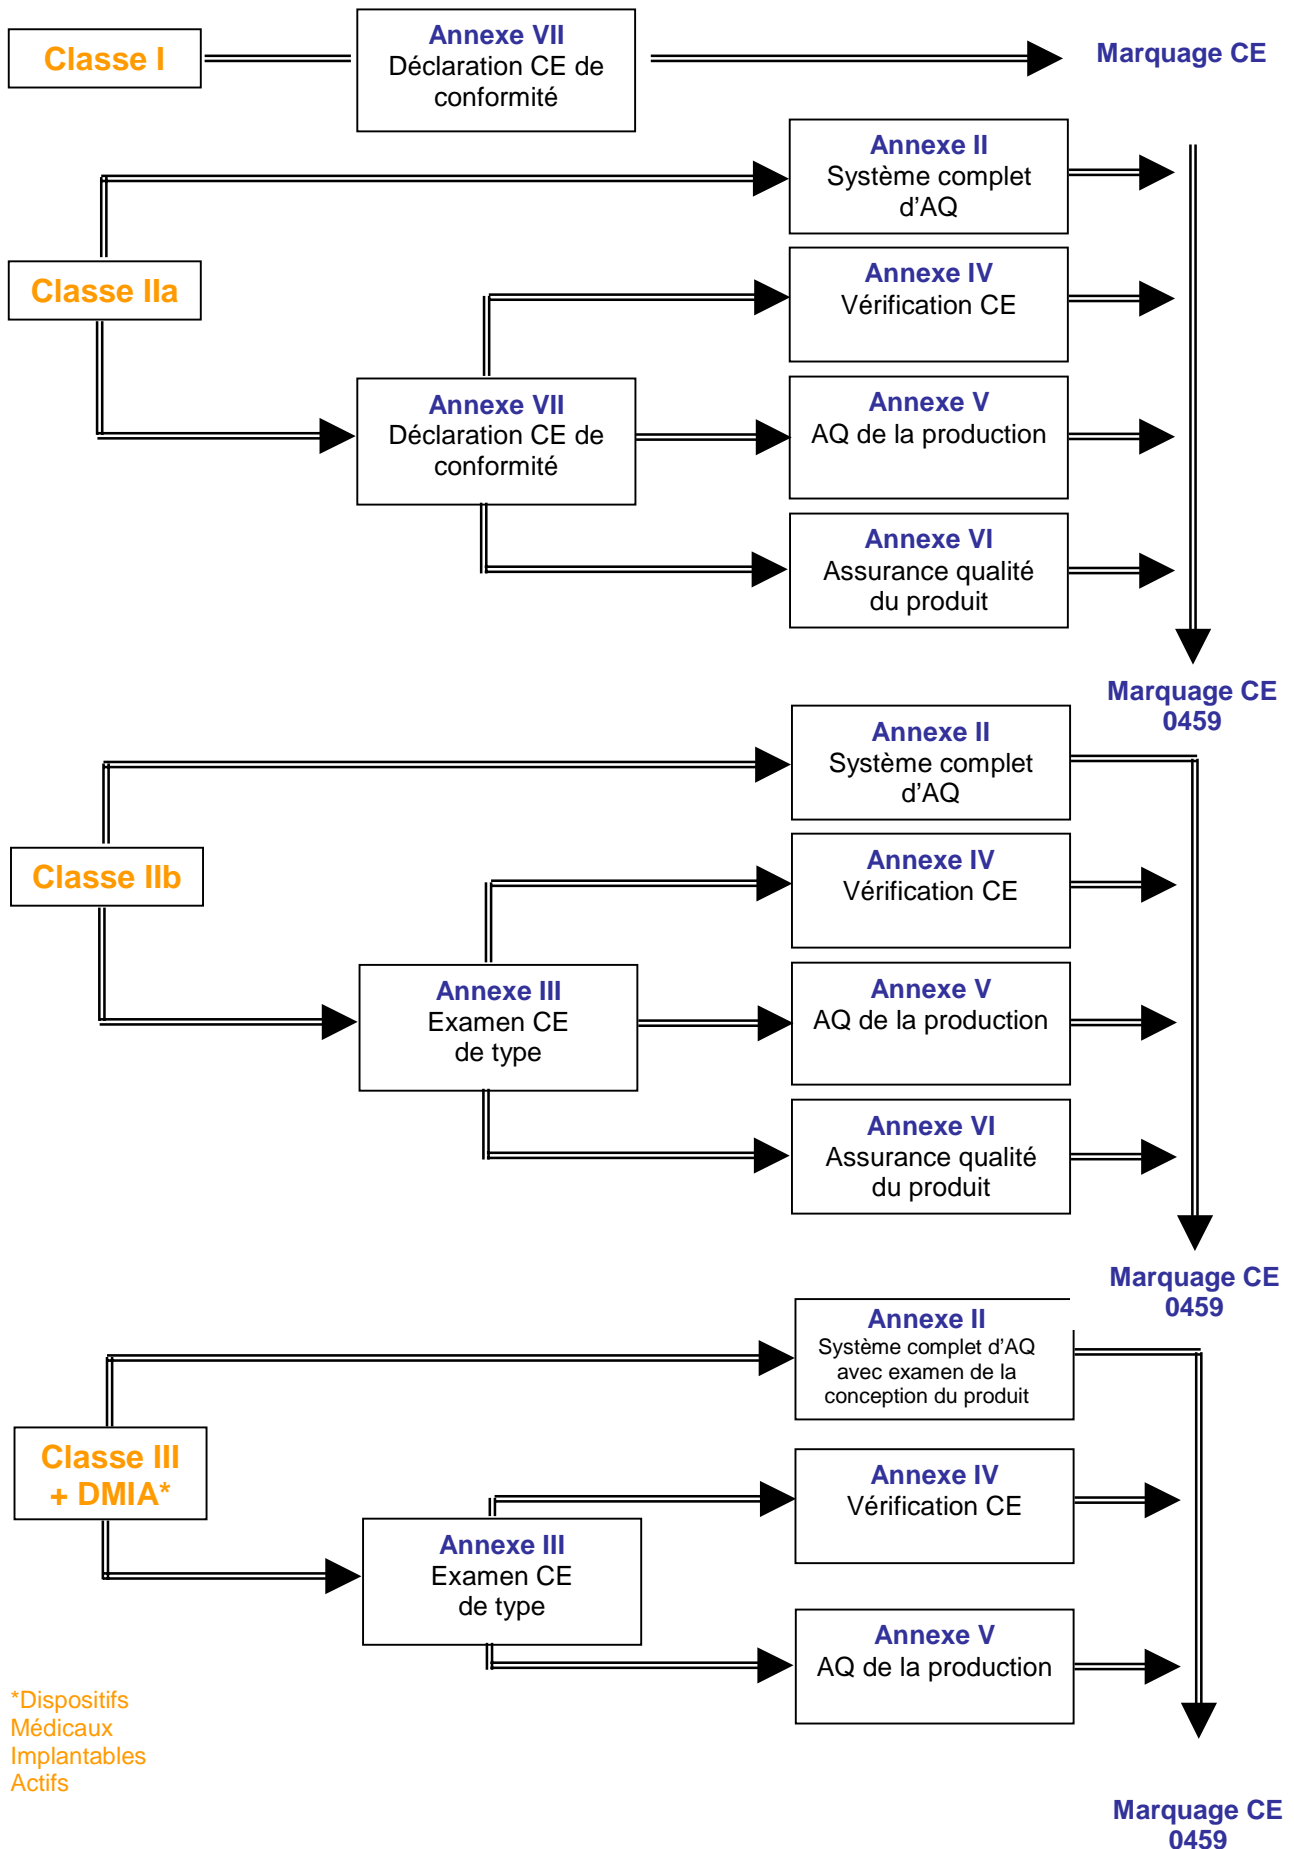

Pour les dispositifs médicaux de classe I mis sur le marché à l'état stérile ou ayant une fonction de mesure : nous consulter